



屋外自立型変換器 SC-PH【簡易設定手順書】

【初期設定】 pH電極の選択・設定を行います。

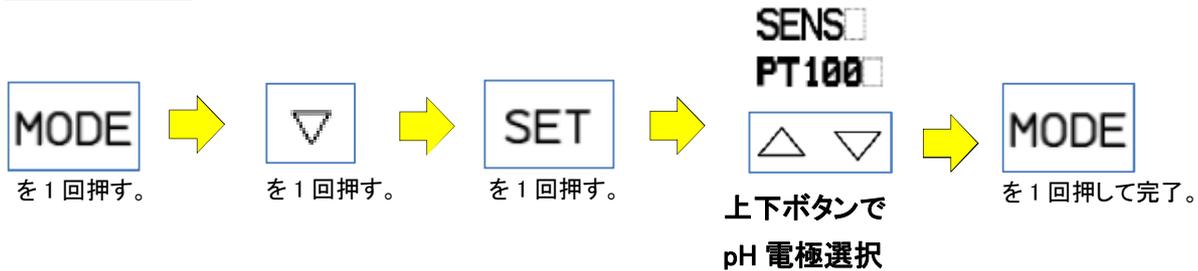

【上下限の警報接点出力設定】 警報レベルの上限/下限数値設定を行います。



＜下限設定＞・・・EVT1に割り当て。

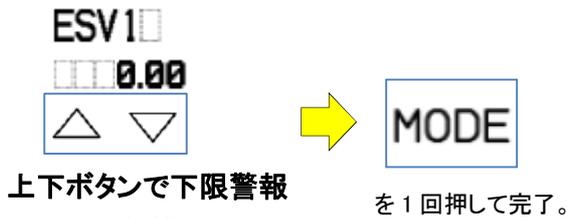

* 一回割り当てが完了すれば、その後は、下記手順で【簡易数値変更】が可能。

SET を1回押す。 → 上下ボタンで数値変更。 → MODE を1回押し完了。

＜上限設定＞・・・EVT2に割り当て。

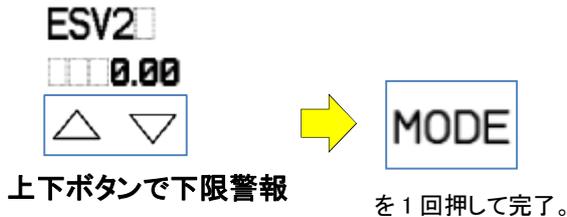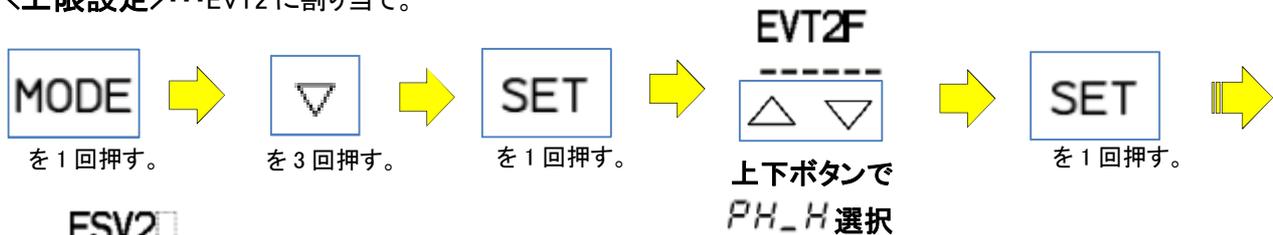

* 一回割り当てが完了すれば、その後は、下記手順で【簡易数値変更】が可能。

SET を2回押す。 → 上下ボタンで数値変更。 → MODE を1回押し完了。


屋外自立型変換器 SC-PH【簡易設定手順書】

【校正】 ……pH7/pH4 標準液を使用。

pH 電極を水洗いした後、pH7 標準液に浸漬して下さい。 ➡



pH 電極を取出し、再度水洗いした後、pH4 標準液に浸漬して下さい。 ➡

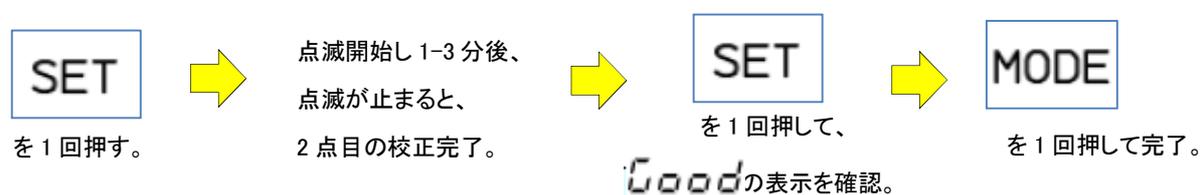

* SC-PHの簡易設定は、以上3項目になります。

アナログ出力範囲設定等、その他の詳細設定は取扱説明書をご確認下さい。